



FICHE DE PRESENTATION DES DISPOSITIFS BIOMETRIQUES (NORME FIA 8868-2018)
PRESENTATION FORM FOR BIOMETRIC DEVICES (FIA STANDARD 8868-2018)

1. GENERALITES / GENERAL

101. CONSTRUCTEUR / MANUFACTURER


FORMULA MEDICINE SRL

- a) Adresse
Address VIA DEI CARPENTIERI, 53 - 55040 CAPEZZANO PIANORE (LU) - ITALY
- b) Téléphone
Phone +39 3202765612
- c) E-mail
E-mail RICCARDO.CECCARELLI@FORMULAMEDICINE.COM

102. MODELE DU DISPOSITIF / DEVICE MODEL

- a) Modèle
Model BIOTRONIX ECG
- b) Vêtements (nom, description)
Garment (name, description) ECG CHEST DEVICE WITH BELT

103. PHOTO DU DISPOSITIF COMPLET / PICTURE OF THE COMPLETE DEVICE

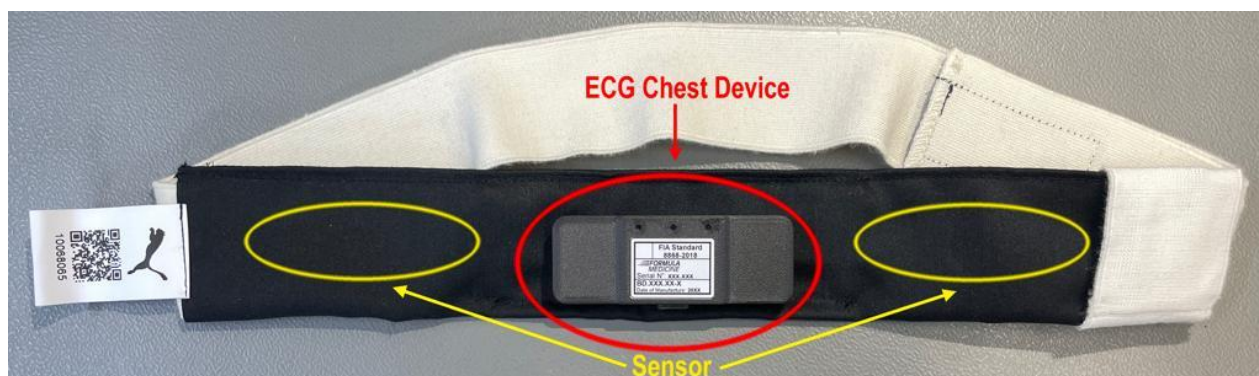

Marque
Make

FORMULA MEDICINE SRL

Modèle
Model

BIOTRONIX ECG

Homologation N°

BD.003.23-A

105. VETEMENT / GARMENT

105.1 Le vêtement est-il homologué selon 8856-2000 ou 8856-2018 ? Is the garment homologated according to 8856-2000 or 8856-2018?



Oui / Yes

Non / No

105.3) Si la réponse à 105.1 OUI / If 105.1 answer is YES

Vue du label d'homologation du vêtement
View of the garment homologation label

105.2) Vue du vêtement / *Garment view*

	
---	---

2. DETAILS DU DISPOSITIF / DETAILS OF THE DEVICE

201. COMPONENTS / COMPOSANT


	Taille Size (mm)	Matériau Material	Position Location
ELECTRONIC UNIT CASE	Largeur / Width 14,8 Longueur / Length 77 Hauteur / Height 28,5	Polyether Ether Ketone (PEEK) + CF10	front side torax
CAPTEURS / SENSORS	Largeur / Width 70 Longueur / Length 20 Hauteur / Height 3	Conductive yarn	front side torax
CAPTEURS / SENSORS	Largeur / Width Longueur / Length Hauteur / Height		
CABLES D'ALIMENTATION / CABLES FOR POWER SUPPLY	NA		
CABLES POUR TRANSMISSION DE DONNEES / CABLES FOR/ DATA TRANSMISSION	NA		
CABLES (AUTRES) / CABLES (OTHERS)	NA		
CONNECTEURS / CONNECTORS	NA		
CONNECTEURS / CONNECTORS			
CONNECTEURS / CONNECTORS			

202. VUES DES DIFFERENTS ELEMENTS / VIEWS OF DIFFERENT COMPONENTS

A1-1) Boitier électronique / Electronic unit case :
Vue de dessus / Front view




A1-2) Boitier électronique / Electronic unit case :
Vue de dessous / Back view

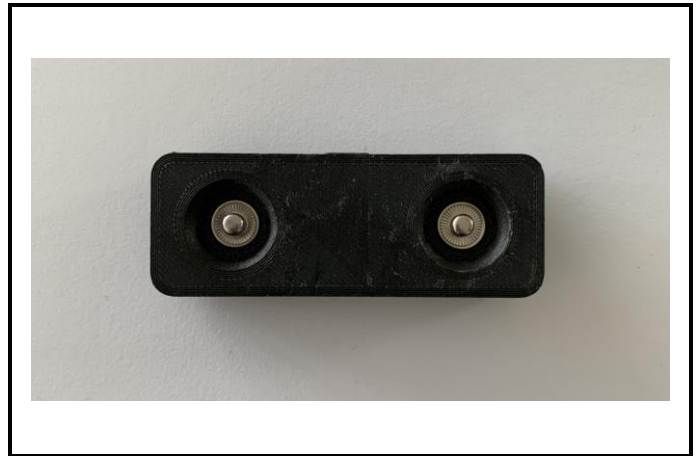

A1-3) Cables / Cables :



A1-4) Cables / Cables :

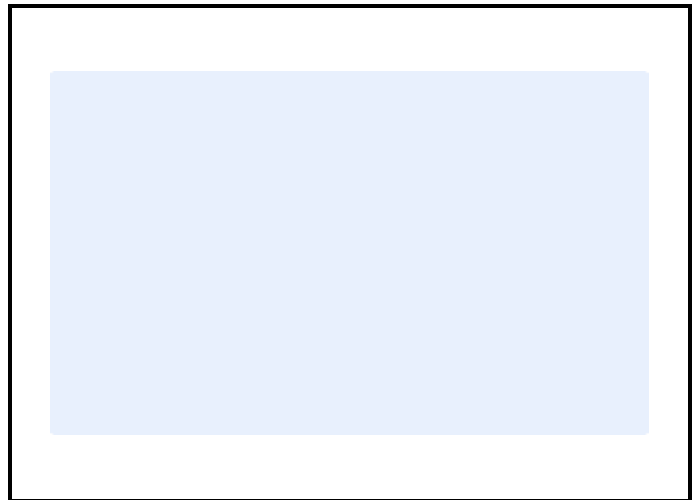

A1-5) Connecteur / Connectors :



A1-6) Connecteur / Connectors :




Marque
Make **FORMULA MEDICINE SRL**

Modèle
Model **BIOTRONIX ECG**


Homologation N°

BD.003.23-A

A1-7) Capteur / Sensor : ECG

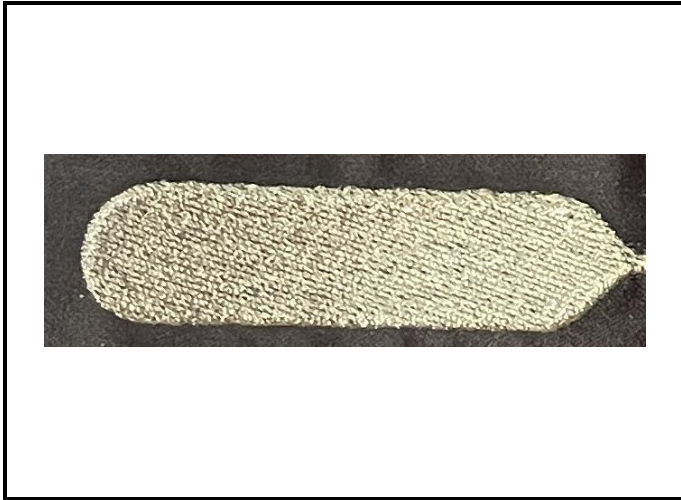

A1-8) Capteur / Sensor :

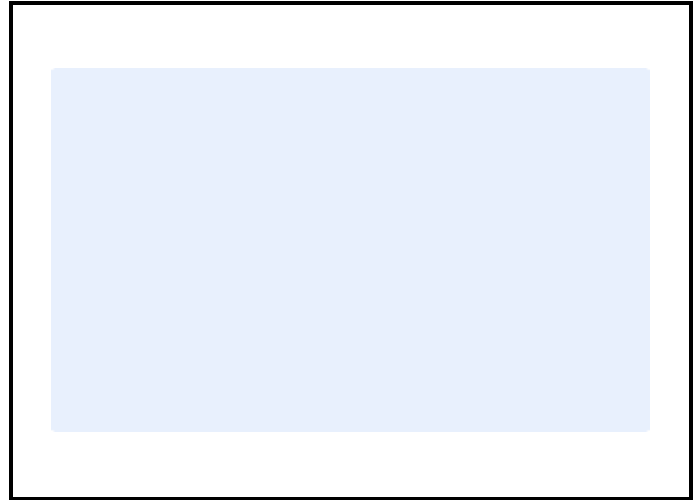

3. ETIQUETTES D'HOMOLOGATION ET DE IDENTIFICATION / *HOMOLOGATION AND IDENTIFICATION LABELS*


301. ETIQUETTES / *LABELS*

a) Dimensions [mm]
Dimensions [mm]


Etiquette d'homologation
Homologation label
60 x 22

Etiquette d'identification
Identification label
23 x 17

B1-1) Etiquette d'homologation sur le vêtement
Homologation label on the garment

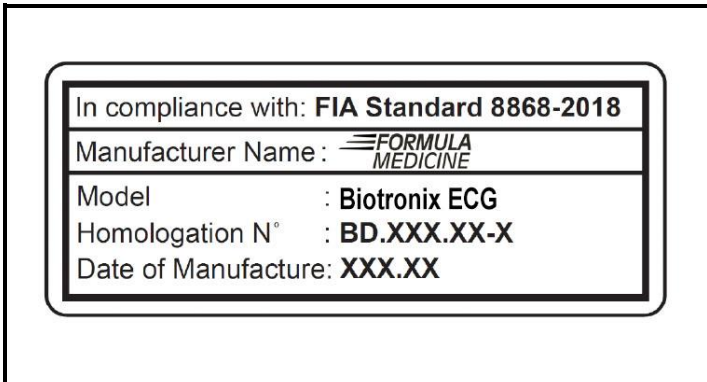

B1-2) Etiquette d'identification fixée sur le boîtier
Identification label affixed on the casing

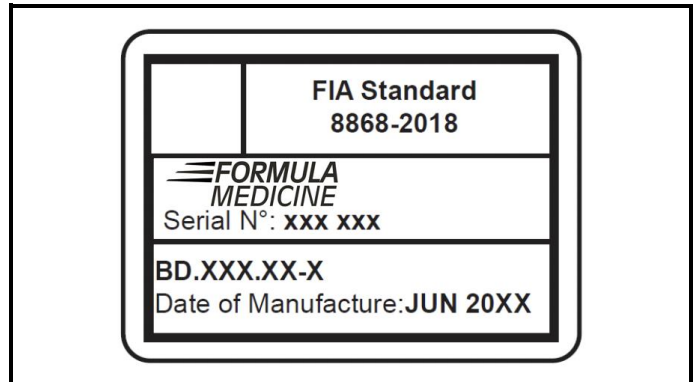

B1-3) Marquages pour les éléments démontables
Marking for dismantable components



Marque
Make

FORMULA MEDICINE SRL

Modèle
Model

BIOTRONIX ECG

Homologation N°

BD.003.23-A

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / COMPLEMENTARY INFORMATION

